


Modell Nr. 1770

TEMPERATURZYKLUS- PRÜFGERÄT

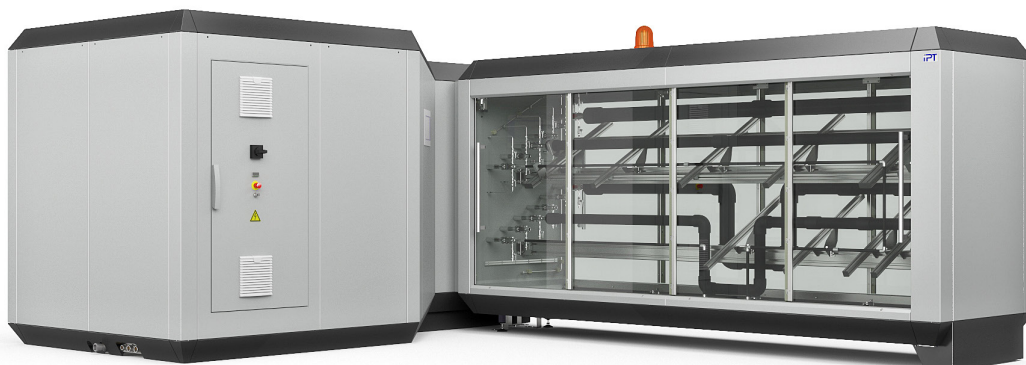

Gemäß

ISO 19893

DVGW W 534

DVGW W 542

DVGW W 543

Mit Hilfe des Temperaturwechsel-Prüfgeräts wird die Beständigkeit von Verbindungen an Rohrleitungssystemen mit starren oder flexiblen Rohren aus Thermoplasten gegen Temperaturwechselbeanspruchung geprüft. Dies gilt für Rohrleitungssysteme, die für den Einsatz bei Druckwasseranwendungen mit Warm- und Kaltwasser vorgesehen sind.

EINFACHE UND SICHERE BEDIENUNG

- > Automatisch ablaufende Prüfungen mit programmierbaren Zykluszahlen und -zeiten, Temperaturen etc.
- > Komfortable Bedienung und übersichtliche Visualisierung über PC-Steuerung
- > Spannvorrichtung mit Wägezelle und Messtechnik für die Anfangszugbeanspruchung
- > Prüflingsgestell in diagonaler Anordnung für bessere Zugänglichkeit

ZUVERLÄSSIGE PRÜFERGEBNISSE

- > Möglichkeit zur Einstellung des Volumenstroms im Einzelprüfstrang (optional auch geregelt)
- > Mikroprozessorgesteuerte, selbstlernende Druckregelung mit automatischer Bruchererkennung
- > Konstante Prüftemperatur durch große Speicher. Hohe Druckgenauigkeit und präzise Durchflussregelung
- > Durchflussmessung und Aufzeichnung (optional)

DAUERHAFT WIRTSCHAFTLICHKEIT

- > Hochwertige Gerätekomponenten garantieren eine hohe Maschinenverfügbarkeit, lange Lebensdauer und geringe Unterhaltskosten
- > Energieeffiziente Umwälz- und Druckpumpen
- > Kalt- und Warmwasserspeicher mit jeweils eigenen Umwälz- und Druckpumpen

MODERNE SPITZENTECHNOLOGIE

- > Schnittstelle zu IptDataLogging®
- > Gleichzeitige Prüfung von unterschiedlichen Rohrsystemen



AUSFÜHRUNGEN TEMPERATURWECHSEL-PRÜFGERÄT

VERSORGUNGSEINHEIT (1)		V1770-0001	V1770-0004
Druckbereich	bar	4 - 16	4 - 10
Temperaturbereich Kaltzyklus	°C	20 - 30	
Temperaturbereich Warmzyklus	°C	50 - 95	
Temperaturgenauigkeit im Prüfling	°C	bei 95 ± 1,5 bei 20 ± 4	
Regelgenauigkeit Temperaturregler	°C	± 0,2	
Messgenauigkeit Druck	%	0,25 vom Endwert des Drucksensors	
Druckgenauigkeit im Prüfling	bar	+0,2/-0,1 bei 10 bar +0,3/-0,15 bei 15 bar	+0,2/-0,1 bei 10 bar
Zykluszeit	min	3 ... 9.999	
Max. Anzahl der Zyklen je Prüfung		99.999	
Fassungsvermögen Warmwasserspeicher	l	700	
Fassungsvermögen Kaltwasserspeicher	l	700	
Speichertyp		drucklos	
Liefermenge der Pumpen bei 10 bar	m ³ /h	17	6
Liefermenge der Pumpe bei 16 bar	m ³ /h	12	-
Max. Summenquerschnitt bei 16 bar / 0,5 m/s	mm ²	6.400	-
Max. Summenquerschnitt bei 10 bar / 0,5 m/s	mm ²	9.500	3.300
Plattenwärmetauscher zum Anschluss an eine externe Kühlwasserversorgung		✓	
Externes Kühlaggregat		+	
Bedienung am Gerät		über 10,4" TFT Touch Screen	
Bedienung über PC im Netzwerk		+	
Kompatibel mit IptDataLogging®		ab Version 5.x	
Zulässige Umgebungstemperatur	°C	+5 bis +25	
Max. relative Luftfeuchtigkeit	%	70 nicht kondensierend	
Geräuschemission	dB(A)	< 70	
Spannungsversorgung		230/400 V, 50 Hz * Sonderspannung	
CE-Konformität		✓	

✓ inklusive

+ verfügbar/optional

O wählbar

- nicht verfügbar

* auf Anfrage erhältlich

AUSFÜHRUNGEN TEMPERATURWECHSEL-PRÜFGERÄT

ZWISCHENGESTELL (2)	V1770-0101	V1770-0100
Max. Anzahl Prüfstränge	6	6
Aufstellungsvariante	A	B
✓ inklusive	+ verfügbar/optional	O wählbar
		- nicht verfügbar
		* auf Anfrage erhältlich

AUSFÜHRUNGEN TEMPERATURWECHSEL-PRÜFGERÄT

PRÜFKAMMER (3)	V1770-0030
Max. Anzahl Prüfstränge	6
4-teilige, transparente Schiebetüren aus Polycarbonat (beidseitig)	✓
Sicherheitsschalter zur Türverriegelung im Warmzyklus	✓
Sensoren für die Brucherennung	✓
Warnlampe	✓
Integrierte Zugvorrichtung	✓
Anschluss für externe Dampfabsaugung	+
Kraftmesszelle 500 N für Zugvorrichtung	+
Kraftmesszelle 2.000 N für Zugvorrichtung	+
Kraftmesszelle 5.000 N für Zugvorrichtung	+
Kraftmesszelle 10.000 N für Zugvorrichtung	+
Multifunktionsmessgerät für Kraftmesszelle	+
Prüflingsgestell diagonal	+
Befestigungsschellen für Prüflingsgestell	+
✓ inklusive	+ verfügbar/optional
	O wählbar
	- nicht verfügbar
	* auf Anfrage erhältlich

AUSFÜHRUNGEN TEMPERATURWECHSEL-PRÜFGERÄT

PRÜFSTRÄNGE	V1770-0080	V1770-0081	V1770-0082	V1770-0085	V1770-0086	V1770-0087
Größe des Prüflinganschlusses Vorlauf / Rücklauf	G1"	G1 ¹ / ₄ "	G1 ¹ / ₂ "	G1"	G1 ¹ / ₄ "	G1 ¹ / ₂ "
Durchflussregelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Druckregelung	-	-	-	✓	✓	✓

✓ inklusive

+ verfügbar/optional

O wählbar

- nicht verfügbar

* auf Anfrage erhältlich

AUSFÜHRUNGEN TEMPERATURWECHSEL-PRÜFGERÄT

DURCHFLUSSMESSER	V1770-0090	V1770-0091	V1770-0092
Messtoleranz	± (1,0 l/min + 4 % vom Messwert)	± (2,0 l/min + 4 % vom Messwert)	± (0,50 l/min ± 0,2 % vom Messwert)
Innendurchmesser Prüfling	10 - 55 mm	22 - 74 mm	10 - 110 mm

✓ inklusive

+ verfügbar/optional


O wählbar

- nicht verfügbar

* auf Anfrage erhältlich

AUFSTELLUNGSVARIANTEN TEMPERATURWECHSEL-PRÜFGERÄT

Aufstellungsvariante A
(Eckaufstellung)

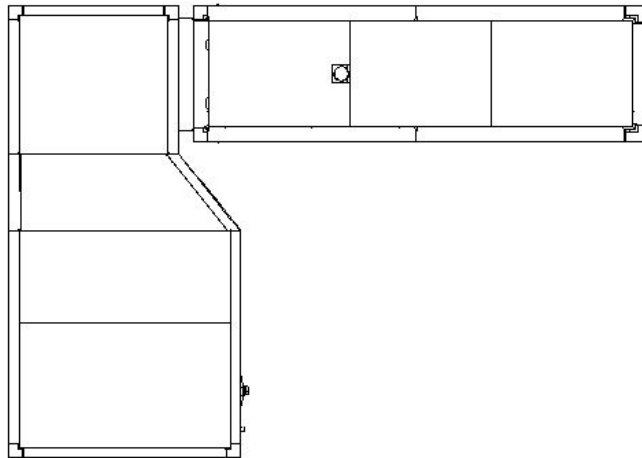

Aufstellungsvariante B
(gerade Aufstellung)

